O líder em Urinálise

FUS-3000Plus NOVO

Urinálise Híbrida

DIRUI

FUS-3000Plus

Urinálise Híbrida

- Herda a tecnologia clássica de análise de imagens de fluxo
- Integrar análise física, química e de elementos formados
- FUS-3000Plus—O líder em urinálise

Princípio Avançado
Parâmetros abrangentes

Teste eficiente
Sistema Estável

BRAVO MOCO MEDICAL
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

PRINCIPIO AVANÇADO

O FUS-3000Plus utiliza tecnologia de análise de imagem de fluxo para resultados precisos e confiáveis.

Tecnologia de fluxo de bainha

O elemento formado de urina é direcionado pelo líquido da bainha com uma única camada para evitar acúmulo ou sobreposição.

Tecnologia de fotografia de alta velocidade

A imagem de 2000 quadros é tirada com ampliação de 400 vezes para aumentar a taxa de detecção.

Identificação Artificial Inteligente (IAI)

(IAI) torna o resultado altamente concordante com o Golden Standard.

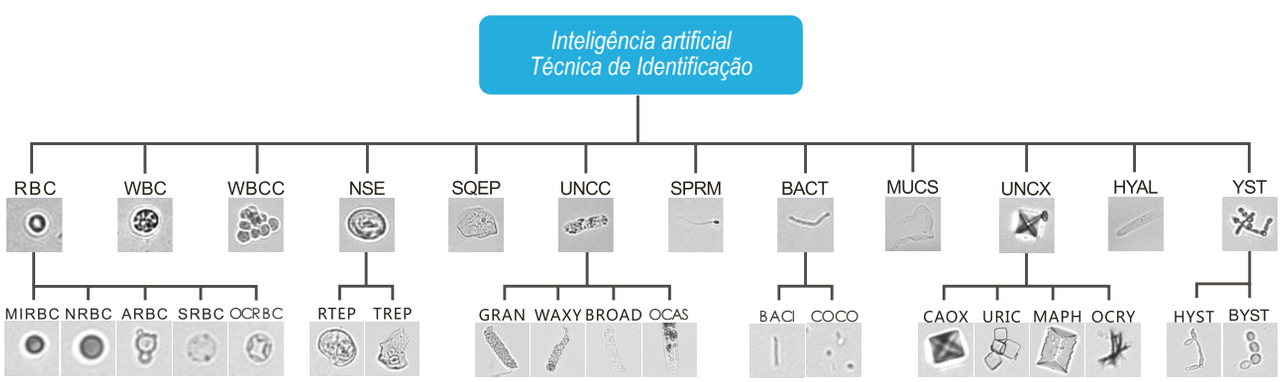

Identificação e classificação

BRAVO MOCO MEDICAL
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

PARÂMETROS ABRANGENTES

O FUS-3000Plus fornece 43 parâmetros de relatório mais abrangentes e 2 resultados de parâmetros de pesquisa do mundo

Parâmetro do Elemento Formado

• 25 parâmetros de elementos formados rompem as dificuldades da técnica da urina formando a análise automática do elemento.

• A subclassificação de partículas oferece uma referência valiosa para o diagnóstico clínico

RBC Normal



Alerta de RBC anormal uniformidade, não uniformidade ou miscibilidade RBC anormal alerta o recurso de hematurese

Celula epitelial



As células epiteliais indicam a posição da lesão de doenças do sistema urinário, como inflamação do trato urinário, necrose aguda do túbulo néfrico e urocistite

BRAVO MOCO MEDICAL
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Elenco Patológico



Elenco patológico indica lesão do parênquima renal como glomerulonefrite, insuficiência renal crônica, etc.

Cristal



A subclassificação de cristal indica pedra nos rins e pode indicar distúrbios metabólicos

Bacteriana

A bactéria é classificada e identificada
A infecção do trato urinário (ITU) é alertada com base no resultado bacteriano, WBC, RBC e química

Parâmetro Químico e Físico

- 14 parâmetros químicos + 4 parâmetros físicos

- O ACR oferece uma estimativa precisa da excreção urinária de albumina de 24 horas e a detecção avançada de disfunção renal em estágio inicial

- A condutividade indica a capacidade de concentração e diluição do Rim

BRAVO MOCO MEDICAL
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

TESTE EFICIENTE

Função de teste de peneira: activar de forma inteligente o teste de elemento formado

Uma operação de chave: execute todos os trabalhos com apenas uma chave

SISTEMA ESTÁVEL

Sistema completo de garantia de qualidade
Calibrador completo, controlo de qualidade, tira e reagente
Controlo de qualidade complexo específico
Constitui um sistema de teste qualificado estável

BRAVO MOCO MEDICAL
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

FUS-3000Plus NOVO

Urinálise Híbrida

Especificação técnica	
Tipo de amostra	Urina
Itens de teste	Itens de Elementos Formados: NRBC, MIRBC, ARBC, SRBC, OCRBC, WBC, WBCC, SQEP,
	GRAN, WAXY, BROAD, OCAS, BACI, SUCO, HYST, BYST, CAOX, URIC, MAPH, OCRY, SPRM, MUCS
	Itens de Química: UBG, BIL, KET, PRO, BLD ,LEU, NIT, GLU, pH, SG, VC (opcional), MALB (opcional),
	CRE (Opcional), CA (Opcional).
	Itens de Física: Condutividade (Opcional), Gravidade Específica (Opcional), Turbidez (Opcional)
Princípios	Elementos Formados: Técnica de Imagem de Fluxo
	Química: Colorimetria Fotoelétrica
Carregamento de amostra	50/270 Amostras (Opcional)
Taxa de transferência	Modo Híbrido/Modo de Elemento Formado: 120 Testes/Hora
	Modo de Química: 240 Testes / Hora
Volume Mínimo de Amostra	Modo híbrido / Modo de elementos formados: 3,0 mL, Modo de química: 1,5 mL
Volume de aspiração	Modo híbrido / Modo de elementos formados: 2,2 mL, Modo de química: 0,4 mL
Interface	Comunicação: Porta RS-232; LIS: porta serial e porta de rede
LIS/ HIS	Comunicação bidirecional com LIS/HIS
Identificação do código de barras	Leitor de código de barras interno
	Leitor de código de barras externo (opcional)
Capacidade de memória	≥ 100.000
Dimensão	779mm×688mm×584mm(L×L×H), 897mm×1566mm×584mm(L×L×H)
Peso	82kg
Temperatura de operação	10-30℃
Umidade	≤75%
Energia	100~240V 50/60Hz

Representante Exclusivo

BRAVO MOCO MEDICAL

Endereço: Centro Logistíco de Talatona
Armazém E05, Luanda - Angola
E-mail: bravomocomedical@gmail.com
Tel: +244 999 901 111 - 938 488 888
Web: www.bravomocomedical.com